Introcan Safety®
Cathéters veineux périphériques de sécurité

Introcan Safety® Code Article		Caractéristiques					Mandrin Code Article
Matériau du cathéter		Gauge	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (mm)	Sans ailettes (S) Avec ailettes (A)	Débit (mL/mn)	
FEP	PUR						
-	4251607-01	24	0,7	14	S	26	-
-	4251614-01	24	0,7	14	A	26	-
4252500-01	4251601-01	24	0,7	19	S	22	-
4254503-01	4253523-01	24	0,7	19	A	22	-
4252519-01	4251628-01	22	0,9	25	S	35	4214099
4254511-01	4253540-01	22	0,9	25	A	35	4214099
4252535-01	4251644-01	20	1,1	32	S	60	4214110
4254538-01	4253566-01	20	1,1	32	A	60	4214110
4252560-01	4251687-01	18	1,3	32	S	105	4214323
4254562-01	4253604-01	18	1,3	32	A	105	4214323
4252551-01	4251679-01	18	1,3	45	S	100	4214137
4254554-01	4253590-01	18	1,3	45	A	100	4214137
4252586-01	4251709-01	16	1,7	32	S	215	-
4252578-01	4251695-01	16	1,7	50	S	210	4214170
4254570-01	4253612-01	16	1,7	50	A	210	4214170
4252594-01	4251717-01	14	2,2	50	S	345	4214218
4254597-01	4253639-01	14	2,2	50	A	345	4214218

Vasofix® Safety
Cathéters veineux périphériques de sécurité avec site d'injection

Vasofix® Safety Code Article		Caractéristiques				Mandrin Code Article
Matériau du cathéter		Gauge	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (mm)	Débit (mL/mn)	
FEP	PUR					
-	4269071S-01	24	0,7	19	22	-
4268091S-01	4269098S-01	22	0,9	25	36	4215095
-	4269217S-01	20	1,1	25	65	4215117
4268113S-01	4269110S-01	20	1,1	33	61	4219104
4268334S-01	4269330S-01	18	1,3	33	103	4219139
4268130S-01	4269136S-01	18	1,3	45	96	4219120
4268172S-01	4269179S-01	16	1,7	50	196	4219171
4268210S-01	4269225S-01	14	2,2	50	343	4219201

Dispositifs médicaux de classe IIa
Introcan Safety® est indiqué pour les prélèvements sanguins, le monitorage de la pression sanguine (cathéter en FEP uniquement) et l'administration de solutions médicamenteuses par voie intraveineuse périphérique. Vasofix® Safety est indiqué pour les transfusion sanguines et l'administration de solutions médicamenteuses par voie intraveineuse périphérique.
Certificat CE délivré par TÜV SÜD (0123)
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.
Produits non pris en charge au titre de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) au titre de l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale.

Distribués par :
B. Braun Medical I 204, avenue du Maréchal Juin I 92100 Boulogne Billancourt
Tel : 01 41 10 53 00 I Fax : 01 41 10 53 99 I www.bbraun.fr
B. Braun Medical, S.A.S. au capital de 31 000 000 euros I RCS NANTERRE 562 050 856 Ed 01/2016

Fabriqués par :
B. Braun Melsungen AG I Carl-Braun Str. 1 I 34212 Melsungen I Allemagne

ecofolio imprimé sur papier de forêt éco-gérée.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photos non contractuels.
Document réservé aux professionnels de santé.

Réf. 301322P_20160115_20210115

Introcan Safety®, Vasofix® Safety

Cathéters veineux périphériques avec sécurité passive

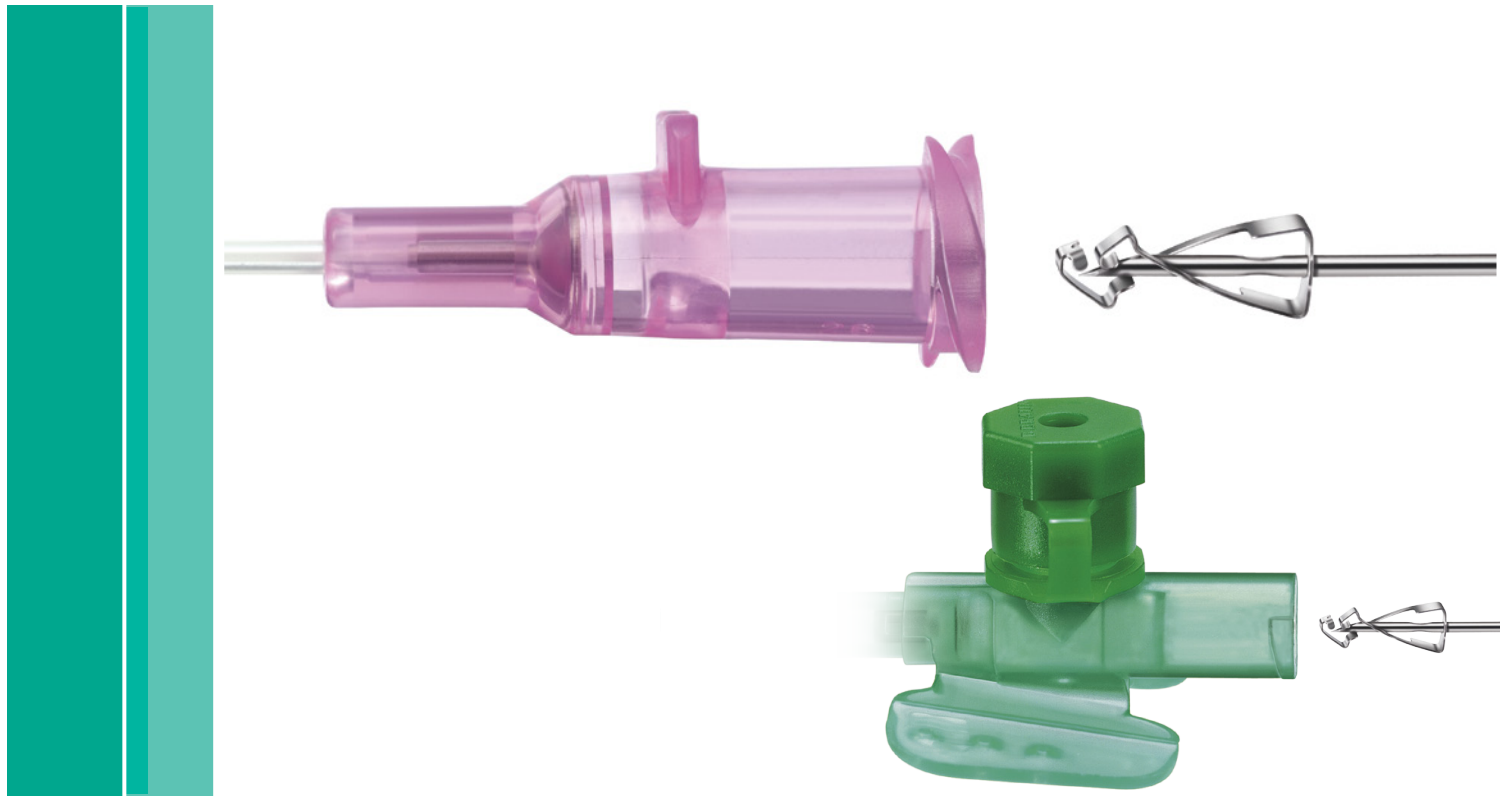

Poster de mise en place

Notre mission
Vous Protéger

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Recommandations pratiques pour la pose d'Introcan Safety® et Vasofix® Safety

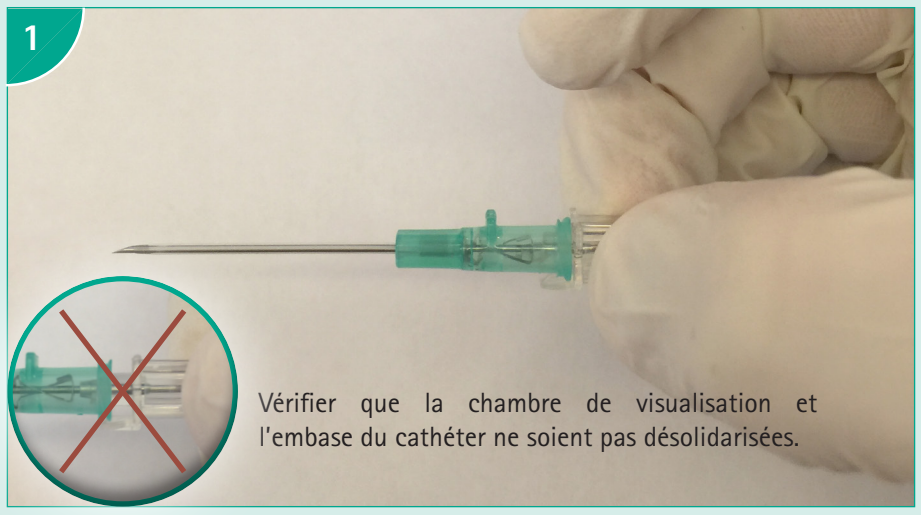

Préparer la pose du cathéter

- Placer un garrot sur le bras du patient et préparer le site de ponction selon les protocoles en vigueur dans l'établissement.
- Saisir la chambre de visualisation du cathéter entre le pouce et le majeur et retirer le capuchon protecteur avec l'index.

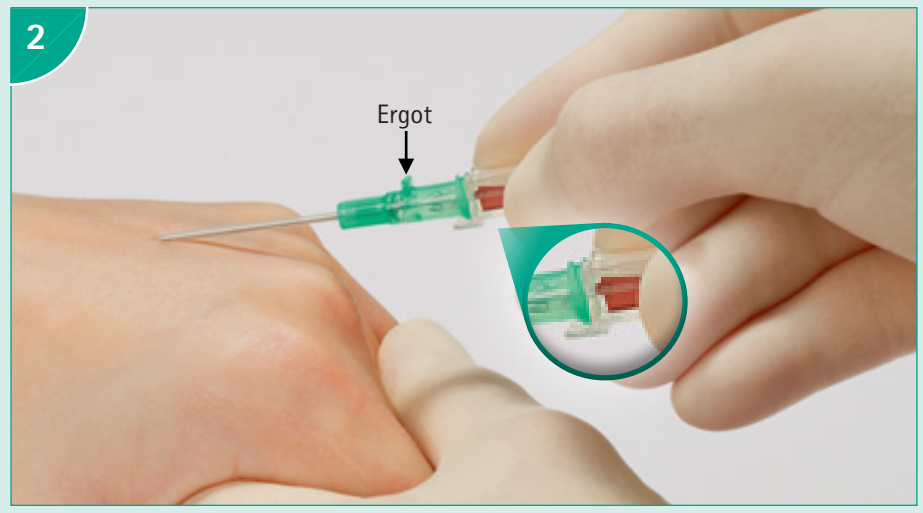

Insérer le cathéter

- Piquer selon un angle de ponction adéquat (l'ergot vers le haut indique que le biseau est bien orienté pour piquer).
- Observer le reflux sanguin dans la chambre de visualisation du cathéter.

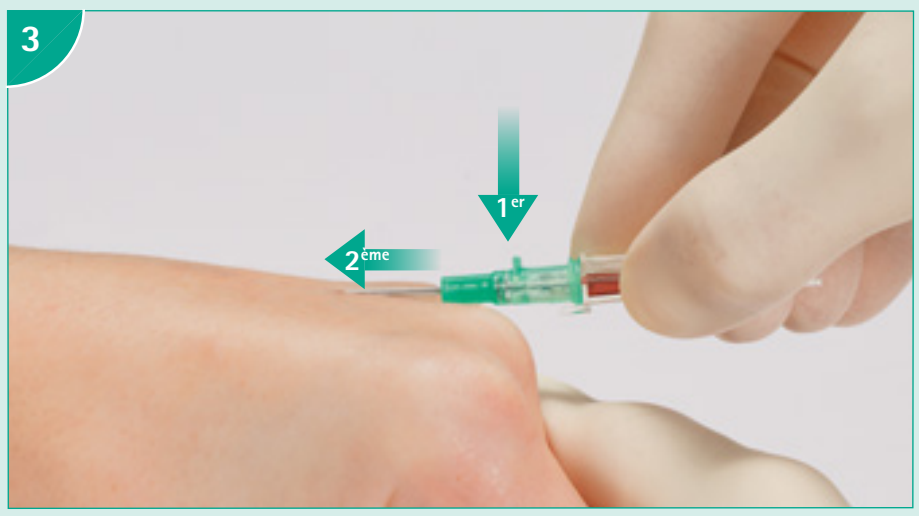

Baisser et avancer légèrement le cathéter

- Réduire l'angle de ponction en baissant le cathéter.
- Avancer légèrement le cathéter pour s'assurer que l'extrêmité de la canule est bien dans la veine.

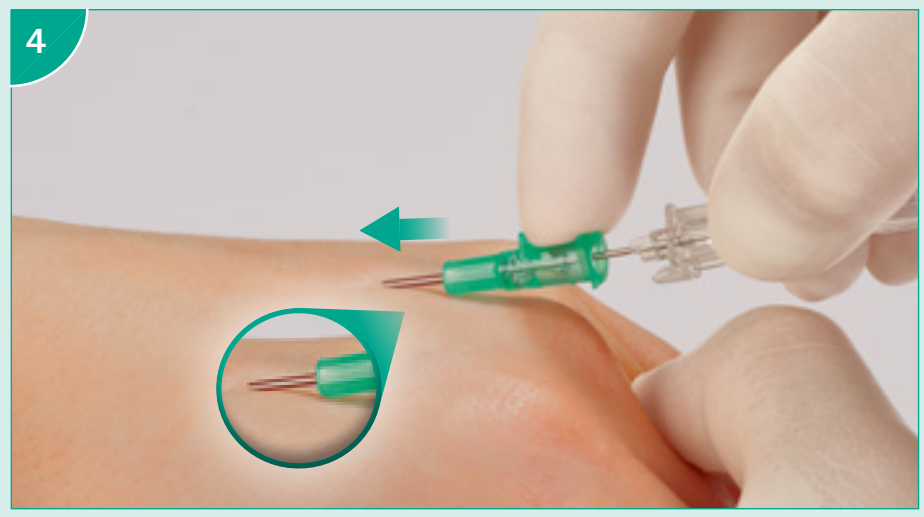

Monter le cathéter

- En poussant l'ergot ou l'ailette (si applicable), commencer à monter le cathéter dans la veine.
- Un second reflux sanguin va apparaître entre l'aiguille et la canule pour confirmer que le cathéter n'a pas transpercé la veine.
- Finir de monter le cathéter.

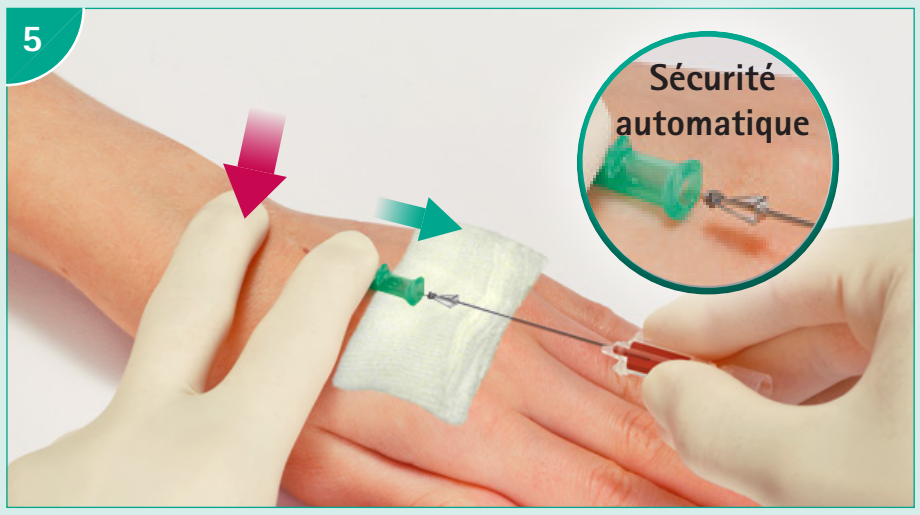

Retirer l'aiguille

- Placer une compresse entre la peau et le cathéter.
- Ôter le garrot.
- Comprimer la veine et maintenir le cathéter avec un doigt sur l'ergot ou l'ailette (si applicable) (technique du V).
- Retirer l'aiguille et l'éliminer dans un collecteur approprié.

Fixer le dispositif

- Connecter un dispositif de perfusion (prolongateur muni d'un robinet 3 voies ou d'une valve bidirectionnelle ...) préalablement préparé.
- Fixer le cathéter avec un pansement adhésif transparent selon les protocoles en vigueur dans l'établissement.
- Tracer la pose dans le dossier patient (date de pose, type de cathéter, site de pose, opérateur)*

Les photos ont été réalisées avec Introcan Safety®.

Ces étapes doivent être réalisées dans le respect des précautions standard et des protocoles en vigueur dans l'établissement.

Ce poster présente les principales recommandations pour la pose d'un cathéter court veineux périphérique. Toutes les étapes de la manipulation, notamment la préparation de l'abord veineux périphérique et la surveillance de la ligne de perfusion n'y sont pas détaillées.

* D'après les recommandations de la SF2H "Surveiller et prévenir les infections associées aux soins". Vol XVIII - n°4 - Septembre 2010.

B BRAUN
SHARING EXPERTISE